



Mölnlycke® Program för trycksårsprevention

Förebygg onödigt lidande

Trycksår är en global utmaning

När problemet uppstått är det försent

25 % av vårdplatserna på sjukhus upptas av patienter med trycksår som oftast har uppstått på sjukhuset – det betyder att trycksår idag är det vanligast förekommande sjukhusförvärvade tillståndet¹.

Sjukhusförvärvade trycksår kan uppstå i alla led i vårdsystemet, och det innefattar akutavdelningen, operationsrummet, post-op och intensivvårdsavdelningen. Upp till 45 % av sjukhusförvärvade trycksår uppstår i operationsrummet².

Detta går att ändra på


Det finns kliniker som aktivt utmanar sjukhusförvärvade trycksår för alla patientkategorier.



Var 30:e minut som passerar efter 4 timmars operation ökar risken för att trycksår uppstår med cirka

33 %³

Kostnaden för att behandla trycksår är
3,6 gånger
högre än kostnaden för förebyggande åtgärder⁴.






”Det smärtsamma trycksår jag fick under ett kejsarsnitt har påverkat relationen till mitt barn och min möjlighet att amma. Såret tog över vår vardag och fick mig att känna mig hjälplös som mamma och partner.”

Sari

35-årig kvinna med ryggmärgsskada.

Saris trycksår uppstod under ett planerat kejsarsnitt där inga eller begränsade förebyggande åtgärder för trycksårsprevention vidtogs trots höga riskfaktorer för patienten.

Mepilex® Border Bevisad effekt.

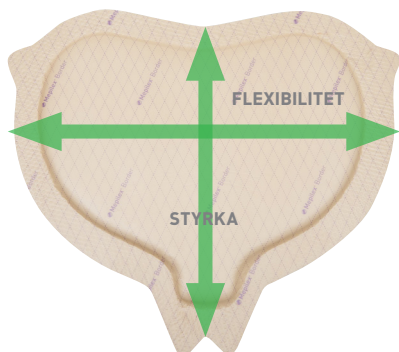


Varför är **Mepilex®** Border Sacrum ett effektivt skydd mot trycksår?

Patenterad Deep Defense®-teknik


Vertikal Styrka som står emot skjuv- och glidkrafter och **horisontell flexibilitet** skyddar mot de yttre krafter som orsakar trycksår, och upprätthåller förbandets struktur, även efter absorption av svett⁵.

Yttre glidskikt

Låg friktion mot stödytan (t.ex. en madrass)

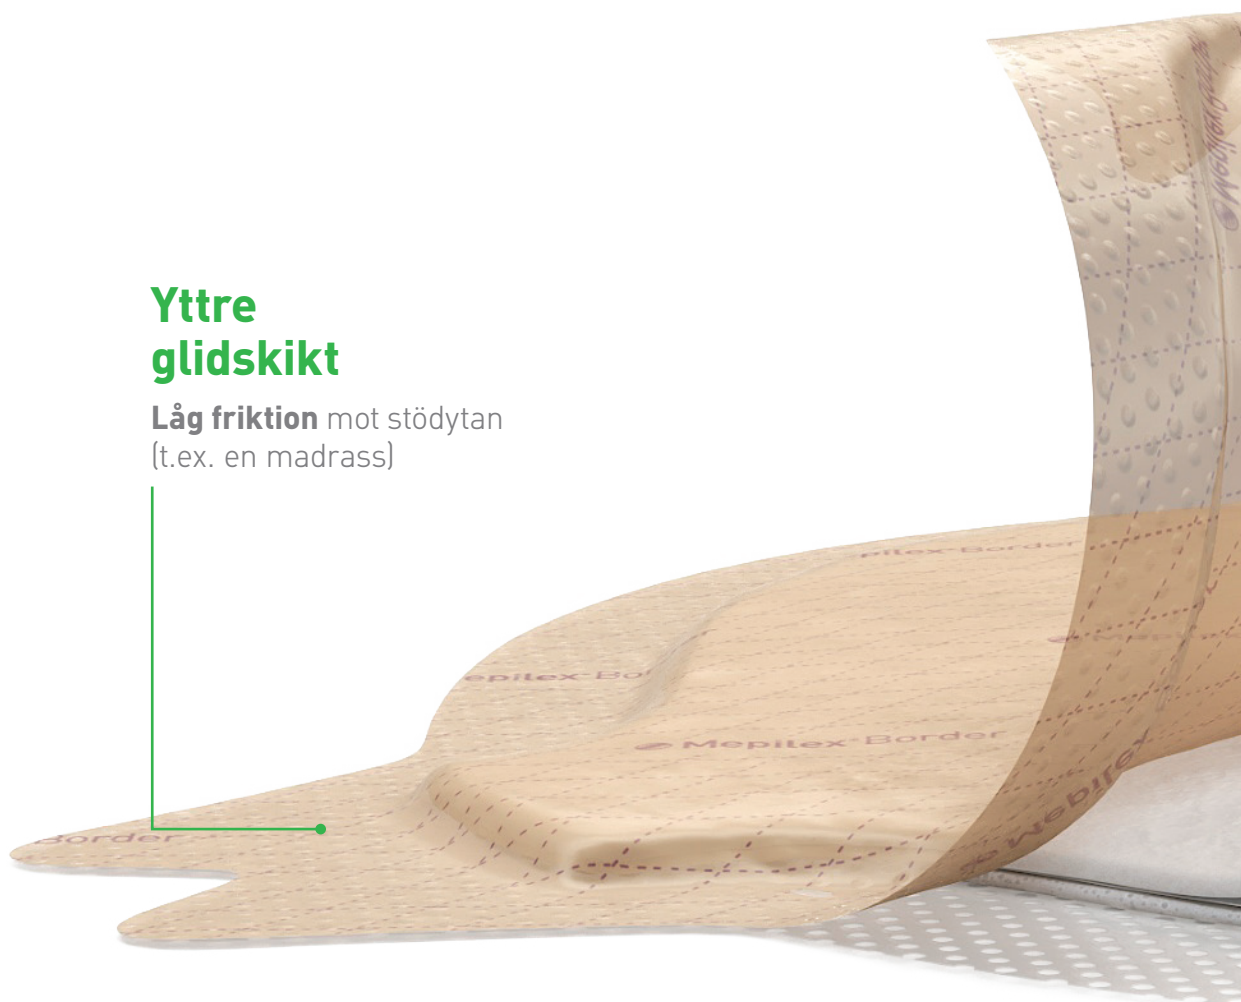

Minimera alla fyra yttre riskfaktorer




TRYCK



FRIKTION



SKJUVNING





MIKROKLIMAT

Mepilex Borders unika design minskar effektivt tryck, skjuv, friktion och optimerar mikroklimatet^{6,7}

Beprövad. Rekommenderad.

Internationella kliniska riktlinjer för prevention²

Användning av förebyggande förband rekommenderas.

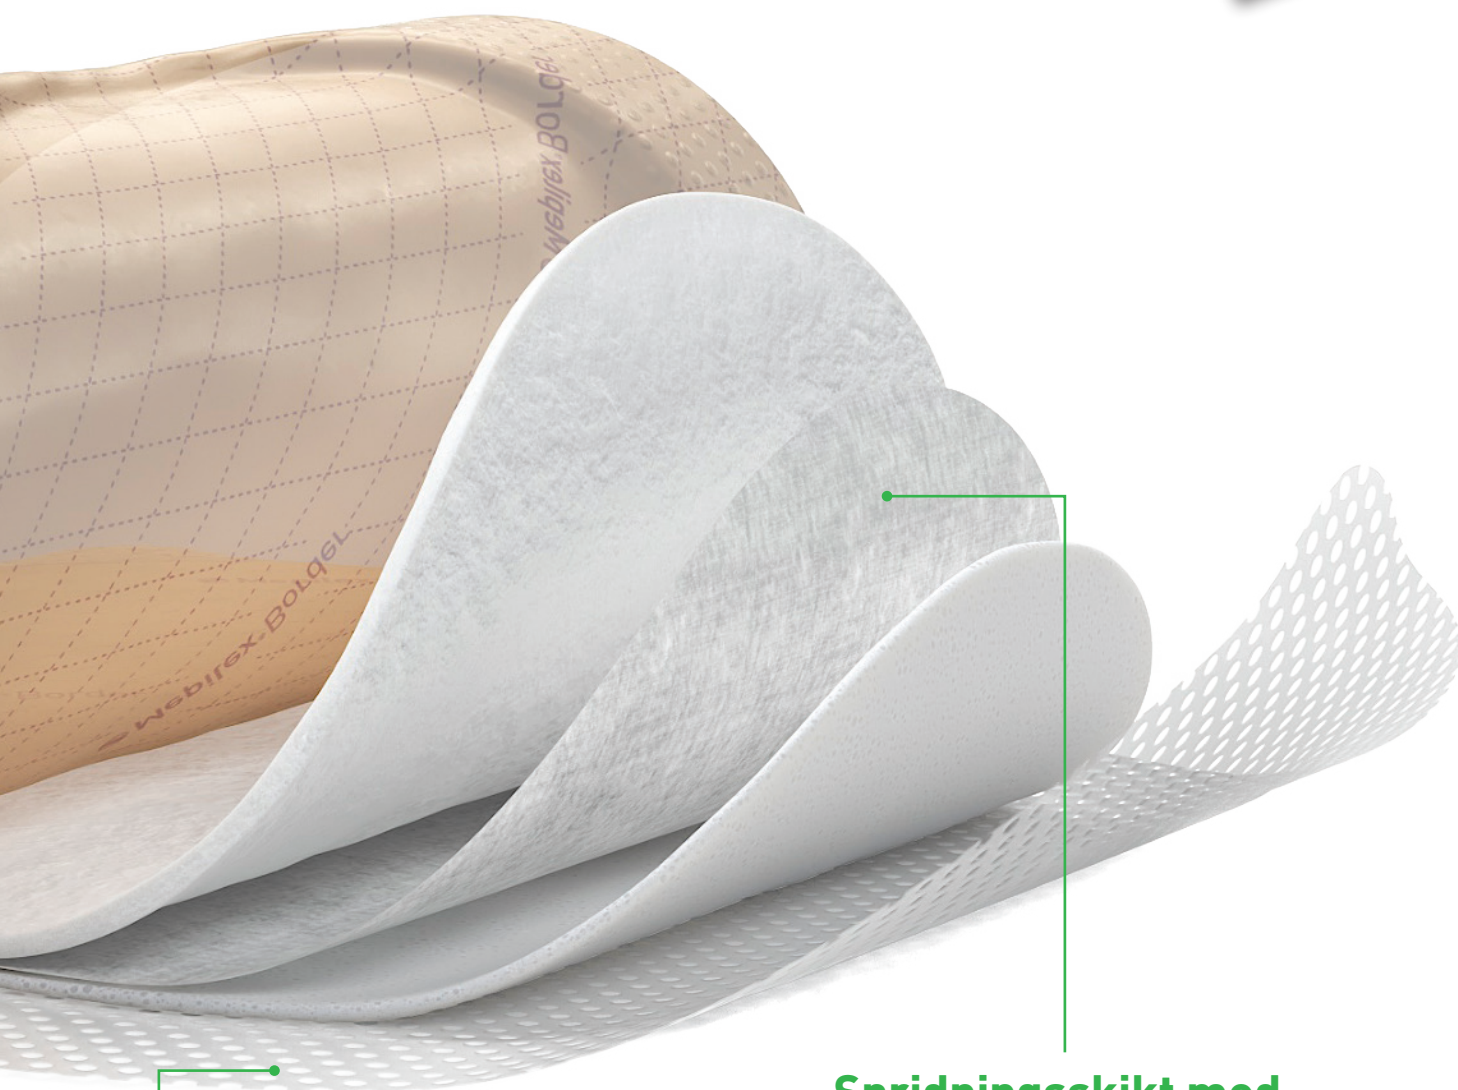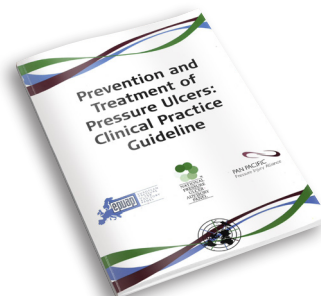

Safetac® sårkontaktlager

Minskar smärta vid hudinspektion och förbandsbyte⁹.

Spridningsskikt med


Deep Defense-teknik.

En optimerad balans mellan styrka och flexibilitet som skyddar patienten från vävnadsdeformationer, som är en av de huvudsakliga orsakerna till att trycksår uppstår⁸. Absorberar och begränsar överföring av tryck- och skjuvkrafter⁶.

Mepilex® Border förebygger effektivt trycksår vid användning tillsammans med vedertagna preventionsprotokoll.


1 **88 %** Minskning av sjukhusförvärvade trycksår i sakrum på intensivvårdsenheten

- ✓ RCT Kalowes et al 2016¹⁰
- ✓ 366 intensivvårdspatienter varav 184 patienter i interventionsgruppen/182 patienter i kontrollgruppen
- ✓ Intervention – Sedvanliga förebyggande åtgärder + Mepilex® Border Sacrum

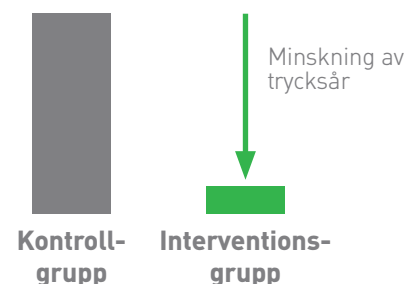

2 **73 %** Lägre kostnader vid användning av Mölnlyckes förband tillsammans med vedertagna preventionsprotokoll

- ✓ Santamaria et al 2013 Border trial I ¹¹ Santamaria et al cost analyse of border trial I ⁴
- ✓ Randomiserad kontrollerad prövning på intensivvårdsenhet med 313 patienter, varav 161 patienter i interventionsgruppen/152 patienter i kontrollgruppen
- ✓ Intervention – Sedvanliga förebyggande åtgärder + Mepilex Border Sacrum och Mepilex®Heel
- ✓ Slutsats – det är 3,6 gånger dyrare att behandla trycksår än att förebygga dem

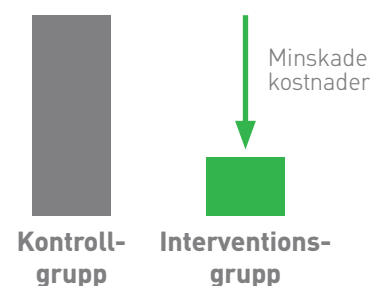


Slutsats

Genom att aktivt arbeta trycksårspåbyggande med evidensbaserade åtgärder går det att minska patienters lidande och de kostnader som sjukhusförvärvade trycksår för med sig¹².

Vill du vara med och göra skillnad?

Kliniska belägg i hierarkisk ordning sammanfattar tillgänglig mängd och typ av evidens för Mepilex Border Sacrum och Mepilex Border Heel vid användning för trycksårspåbyggande.*


Evidens för Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel vid påbyggande av trycksår

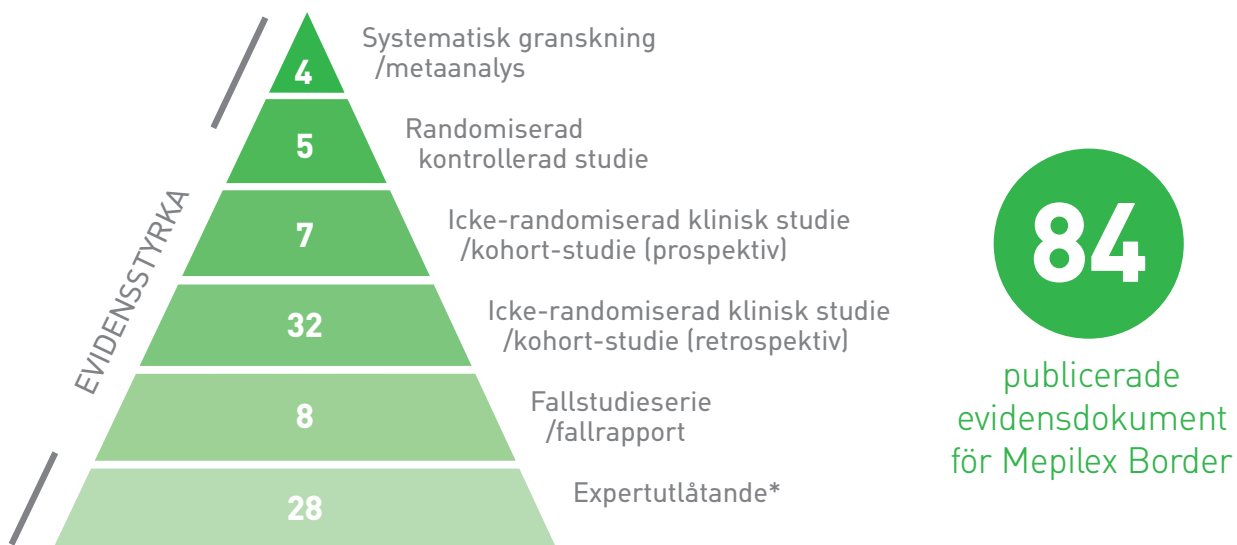

* Inkluderar tre internationella kliniska riktlinjedokument med rekommendationer baserade på tillgänglig forskning och expertutlåtanden. Även om riktlinjerna inte är specificerade för olika varumärken identifieras endast Mepilex Border i de kliniska bevisen, inte Allevyn® Life, Optifoam®, AQUACEL® Foam eller Biatain®.

Mölnlycke Healthcare report GMCS/2017/102 V8 Dressings for pressure ulcer prevention: a review of the pre-clinical, clinical and economic evidence (april 2018). Arkivdata

Prevention handlar om evidensbaserade strategier²

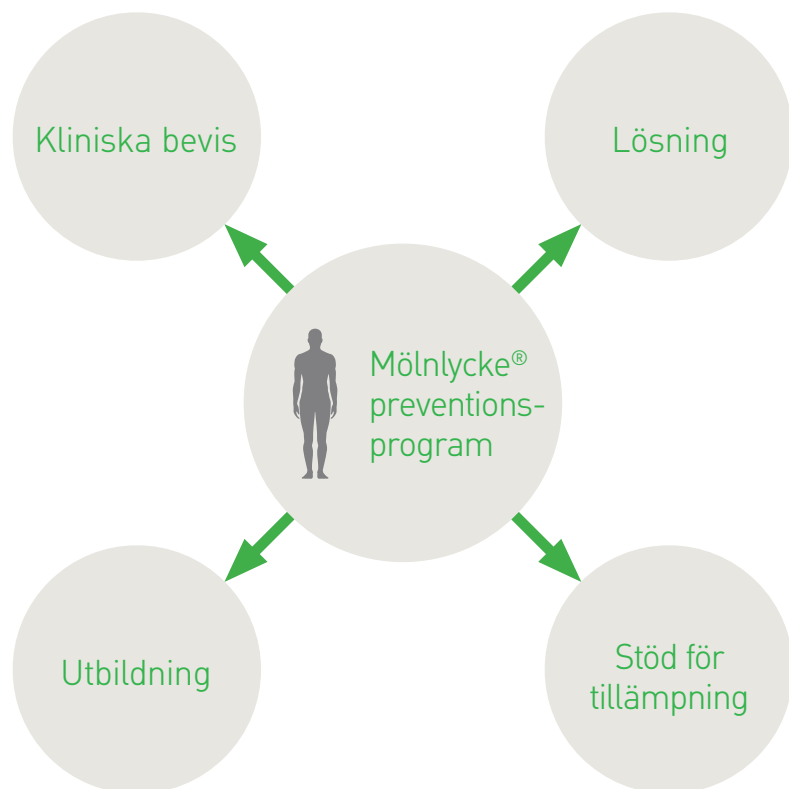

* Rekommendation baserad på Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.

Kontakta din Mölnlycke Health Care-representant för mer information om implementering av Mepilex® Border i ert befintliga preventionsprogram. Om din vårdinrättning är i startgrupparna med preventionsarbetet kan vi erbjuda stöd för att etablera anpassade protokoll och rutiner.

Beställningsinformation för Mepilex® Border Heel

Art. nr	Storlek cm	St/hyllförpackning.	St/transportförpackning
282750	22 × 23	6	30

Beställningsinformation för Mepilex® Border Sacrum

Art. nr	Storlek cm	St/hyllförpackning.	St/transportförpackning
282450	22 × 25	5	30
282050	16 × 20	5	40
282500	15 × 15 (Tidigare design)	5	50

Referenser: **1.** Posnett, J., Gottrup, F., Lundgren, H., Saal, G. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. *Journal of Wound Care* 2009;18(4):154-161. **2.** National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. **3.** Schoonhoven, L., Defloor, T., van de Tweel, I., Buskens, E., Grypdonck, M.H. [2002] Risk indicator for pressure ulcers during surgery. *Applied Nursing Research* 15(3): 163-73. **4.** Santamaria, N., Liu, W., Gertz, M. The cost-benefit of using soft silicone multi-layered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: a within-trial analysis of the Border Trial. *International Wound Journal* 2015;12(3):344-350. **5.** Studying the effect of different prevention dressings on protecting soft tissues from high stresses and deformation. Ref. nr* 001 Arkivdata. 2017. **6.** Call, E., Pedersen, J., Bill, B., Black, J., Alves, P., Brindle, C.T., Dealey, C., Santamaria, N., Clark, M. Enhancing pressure ulcer prevention using wound dressings: what are the modes of action? *International Wound Journal* 2015;12(4):408-413. **7.** Laboratory test report. Data on file, Mölnlycke Health Care 2016. **8.** Levy, A., Gefen, A. Assessment of the Biomechanical Effects of Prophylactic Sacral Dressings on Tissue Loads: A Computational Modelling Analysis. *Ostomy Wound management* 2017;63 (10):48-55. **9.** White, R. A multinational survey of the assessment pain when removing dressings. *Wounds UK* 2008;4(1):14-22. **10.** Kalowes P, Messina V. et al. Five-Layered Soft Silicone Foam dressing to Prevent Pressure ulcers in the intensive care unit. *Am J of Critical Care* 2016; 25: 6, 108-119. **11.** Santamaria, N., Gertz, M., Sage, S., McCann, J., Freeman, A., Vassiliou, T., De Vincentis, S., Ng, A.W., Manias, E., Liu, W., Knott, J. A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered foam dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: the border trial. *International Wound Journal* 2015;12(3):302-308. **12.** World Union of Wound Healing Societies. Consensus Document. The role of dressings in prevention of pressure ulcers. *Wounds Int* 2016.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sverige. Tel.: + 46 31 722 30 00.
Varumärkena Mölnlycke, Mepilex och Safetac och respektive logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. HQIM000661

AQUACEL är ett registrerat varumärke som tillhör ConvaTec. Allevyn är ett registrerat varumärke som tillhör Smith & Nephew. Optifoam är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries Inc. Biatain är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast Pty Ltd.

